



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
62 - 600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25



Koło, dnia 09.01.2023 r.

SPZOZ.DŚM-ZP.240.22.2022

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania:

„Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku II”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710) informuje o pytaniach i odpowiedziach:

Pytanie nr 1 - Zadanie 1- PRZYRZĄDY , poz.1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania w przyrządzie filtra o skuteczności filtracji BFE, VFE min. 99,99999% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH ?

Odp. Zgodnie SWZ

Pytanie nr 2 - Zadanie 1- PRZYRZĄDY , poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów posiadającego igłę dwukanałową ściętą trójpłaszczyznowo, wykonaną z ABS bez wzmocnienia włóknem szklanym?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3 -Zadanie 1- PRZYRZĄDY , poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonana z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4 - Zadanie 1- PRZYRZĄDY , poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi posiadający logo umożliwiające identyfikację wyrobu na zaciskaczu rolkowym?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5 - Zadanie 4- KANIULE DLA DOROSŁYCH , poz. 1 -11

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie nr 6 - Zadanie 4- KANIULE DLA DOROSŁYCH , poz. 1 -6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylniej z koreczkiem samodomykającym się?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7 - Zadanie 4- KANIULE DLA DOROSŁYCH , poz. 1 -6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylniej wykonanej z PTFE?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8 - Zadanie 4- KANIULE DLA DOROSŁYCH , poz. Bez numeru

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylniej w rozmiarze 16G x 45 mm oraz 14 G x 45 mm ?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9 - Zadanie 4- KANIULE DLA DOROSŁYCH , poz. 7-11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylniej bezpiecznej z koreczkiem samodomykającym się?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10 - PAKIET NR 3 Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dożylnego wklucia centralnego zapakowanego w opakowanie- tackę typu blister z jednym wgłębieniem na płyny, posiadającego w swoim składzie strzykawkę Luer Lock oraz igłotrzymacz o długości 14 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 11 – Pakiet nr 3, Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania szwów posiadającego w swoim składzie nożyczki metalowe ostro-ostre 11,6 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 12 – Pakiet nr 3, Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zdejmowania szwów posiadającego w swoim składzie tampony włókninowe wielkości jaja (22 x 24 cm po rozłożeniu)? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 13

PROJEKT UMOWY § 11, ust. 1-2- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obliczanie ich wartości w następujący sposób:

- § 11, ust. 1, pkt. 1 ; § 11, ust. 2 do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy
- § 11, ust. 1, pkt. 2 do kwoty 0,5% wartości niedostarczonej partii zamówienia
- § 11, ust. 1, pkt. 3 do kwoty 0,5% wartości wadliwej partii zamówienia

Odp. Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie nr 14, Pakiet nr 2, pozycja 1-8

Czy Zamawiający dopuści maski z drenem o długości 2,1m?

odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 15, Pakiet nr 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści filtr o wadze 22g?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 16, Pakiet nr 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracji dla wirusów i bakterii na poziomie 99,999%?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 17, Pakiet nr 2, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową bez wzmocnionego koniuszka blokujący górny zwieracz przełyku?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 18, Pakiet nr 2, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową, której rurka oraz mankiet stanowią dwa osobne elementy połączone ze sobą trwale?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 19, Pakiet nr 2, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową bez znaczników głębokości?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 20, Pakiet nr 2, pozycja 10

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu stosowania w środowisku MRI?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 21, Pakiet nr 2, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową w rozmiarach 1-5?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 22, Pakiet nr 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z dodatkową rurą do worka o długości 120cm?

Odp. Tak dopuszcza

Pytanie nr 23, Pakiet nr 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z workiem bez informacji o braku lateksu na kołnierzu?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 24, Pakiet nr 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści informację o sterylności umieszczoną na opakowaniu jednostkowym w zamian za certyfikat walidacji procesu sterylizacji dołączony do oferty?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 25, Pakiet nr 2, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści maski silikonowe wielorazowe w rozmiarach 0-5?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 26, Pakiet nr 2, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści maski mikrobiologicznie czyste?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 27, Pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną ze znacznikiem głębokości w postaci 2 półpięści?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 28, Pakiet nr 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną ze znacznikiem głębokości w postaci 2 półpięści?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 29, Pakiet nr 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową z blokadą zagryzienia wykonaną z PE?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 30, Pakiet nr 6, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarach: 2,0; 3,3; 4,0 oraz 4,7?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 31, Pakiet nr 6, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści rurkę nosowo-gardłową w rozmiarach 3,0-9,0?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 32, Pakiet nr 6, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną 22G 0,9x25mm o przepływie 36 ml/min, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 33, Pakiet nr 6, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści czyściki do narzędzi elektrochirurgicznych pakowane po 10 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 34, Pakiet nr 6, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści igłę aspiracyjną w rozmiarze 16G o długości regulowanej od 10mm do 50mm?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 35, Pakiet nr 2 poz. 2

Czy zamawiający dopuści jako równoważną maskę tlenową w uniwersalnym rozmiarze pediatrycznym spełniającą wszystkie pozostałe wymagania SWZ ?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 36, Pakiet nr 2 poz. 5

Czy zamawiający dopuści jako równoważną maskę aerolową w uniwersalnym rozmiarze pediatrycznym spełniającą wszystkie pozostałe wymagania SWZ ?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 37, Pakiet nr 2 poz. 14

Czy zamawiający dopuści jako równoważne maski anestetyczne wielorazowe w rozmiarze od 0-5 spełniające pozostałe wymagania SWZ ?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 38, Pakiet nr 2 poz. 15

Czy zamawiający dopuści jako równoważne maski anestetyczne jednorazowe czyste mikrobiologicznie, spełniające pozostałe wymagania SWZ ?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 39,

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie masek tlenowych dla dorosłych z drenem o długości 210 cm?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 40

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 2 oraz 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie masek tlenowych w uniwersalnym rozmiarze dla dzieci z elastomerowym beczciśnieniowym mankietem uszczelniającym, ściśle obejmującą twarz łącznie z brodą dedykowaną małym i średnim dzieciom, z drenem o długości 210 cm?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do nebulizacji z maską dla dorosłych wraz z drenem o długości 210 cm?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 42

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 5 i 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do nebulizacji z maską dla dzieci, w którym maska jest w uniwersalnym rozmiarze dla dzieci z elastomerowym bezciśnieniowym mankietem uszczelniającym, ściśle obejmującą twarz łącznie z brodą dedykowaną małym i średnim dzieciom, z drenem o długości 210 cm?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 43

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie maski do podawania tlenu z rezerwuarem dla dorosłych i drenem o długości 210 cm?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 44

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie maski do podawania tlenu z rezerwuarem dla dzieci i drenem o długości 210 cm?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 45

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra oddechowego elektrostatycznego o masie 23 g, sterylne, przestrzeni martwej 42 ml, z portem kapno, o skuteczności filtracji względem wirusów i bakterii >99,998%, wolny od szkodliwych ftalanów, z datą ważności na opakowaniu jednostkowym?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 46

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 10 wyrazi zgodę na zaoferowanie masek krtaniowych jednorazowych, sterylnych, z mankietem i rurką uformowaną jako jedną całość, z mankietem pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi, z koniuszkiem mankieta nie podwijającym się podczas zakładania, w siedmiu rozmiarach : 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, z informacjami dotyczącymi rozmiaru, wagi pacjenta, rekomendowanej objętości wypełniającej mankieta, maksymalnej objętości wypełnienia mankieta na rurce oraz na opakowaniu, z instrukcją użycia umieszczoną na opakowaniu, z identyfikacją rozmiaru na baloniku kontrolnym, ze znacznikiem prawidłowego usytuowania maski, bez szkodliwych dla zdrowia ftalanów DEHP, bez lateksu, w opakowaniu folia-papier?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika do podawania tlenu przez nos o długości 210 cm?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 12 wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika do podawania tlenu przez nos dla dzieci o długości 210 cm?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 49

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie obwodu oddechowego do aparatu do znieczulenia dla dorosłych z polipropylenu, sterylne, z dwoma rurami o długości 200 cm z łącznikiem Y, łącznikiem kolankowym z portem luer, z dodatkowa rura do worka o długości 150 cm, z bezlateksowym workiem naopranowym o pojemności 2L z oznaczeniem wielkości worka na kołnierzu oraz z łącznikiem prostym 22M-22M do worka; wszystkie elementy w jednym opakowaniu z datą ważności?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SWZ

Czy Zamawiający pakiecie nr 2 poz. 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego obwodu oddechowego z PCV dla dorosłych do aparatu do znieczulenia, o długości ramion 180 cm z łącznikiem Y, łącznikiem kolankowym z portem luer lock, i dodatkowej rurze do worka o długości 100cm, z workiem bezłateksowym neopranowym o pojemności 2 L z oznaczeniem wielkości worka na kołnierzu, z zakończeniami miękkimi od strony aparatu?

Pytanie nr 51


Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 14 wyrazi zgodę na zaoferowanie masek silikonowych do resuscytatora nadające się do sterylizacji w rozmiarach 00-5, od wcześniaków do dużego dorosłego ?

Pytanie nr 52

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 15 wyrazi zgodę na zaoferowanie masek jednorazowych do resuscytatora mikrobiologicznie czystych, pakowanych pojedynczo, bez lateksu, w rozmiarach 0-6 ?


Pytanie nr 53

Pakiet nr 3 poz. 1: czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w torebkę foliowo-papierowa o składzie:

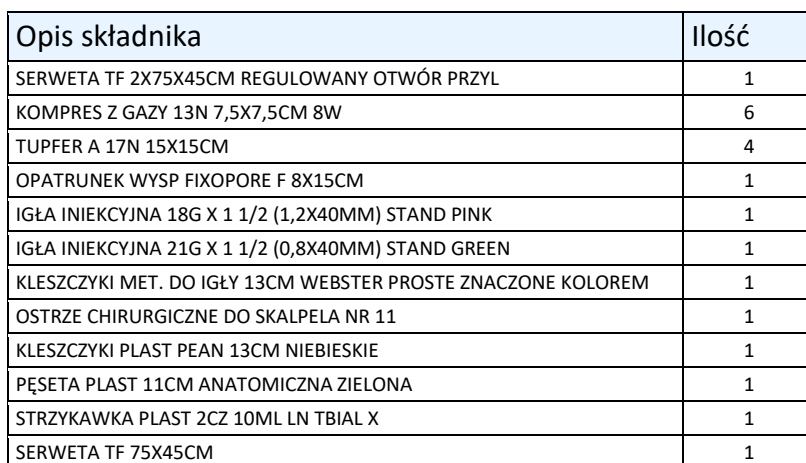

Pytanie nr 54

Pakiet nr 3 poz. 2: czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w twardy blister 2-komorowy, który może służyć jako tacka o składzie:

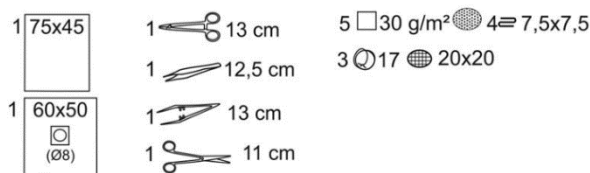


Opis składnika	Ilość
SERWETA FB 60X50CM O8 PRZYL	1
KOMPRES WŁÓKNINOWY 30G 4W 7,5X7,5CM	5
TUPFER A 17N 20X20CM	3
KLESZCZYKI MET. DO IGŁY 13CM WEBSTER PROSTE ZNACZONE KOLOREM	1
NOŻYCY MET. 11CM IRIS PROSTE OSTRO-OSTRE ZNACZONE KOLOREM	1
PĘSETA MET. CHIRURGICZNA 12,5CM ADSON ZNACZONA KOLOREM	1
PĘSETA PLAST 13CM ANATOMICZNA ZIELONA	1
SERWETA FB 75X45CM	1

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 55

Pakiet nr 3 poz. 3: czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w twardy blister 1-komorowy, który może służyć jako tacka o składzie:

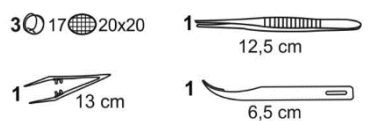

Opis składnika	Ilość
TUPFER A 17N 20X20CM	3
PĘSETA MET. ANATOMICZNA 12,5CM ADSON ZNACZONA KOLOREM	1
OSTRZE CHIRURGICZNE DO ŚCIGAANIA SZWÓW 6,5CM	1
PĘSETA PLAST 13CM ANATOMICZNA ZIELONA	1

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 56, dot. projektu umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Tak

Pytanie nr 57, Pakiet 1, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z wysokiej jakości medycznego PCV o długości 55 mm w części przezroczystej, całość przyrządu-aparatu wolna od ftalanów DEHP oraz lateksu (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana ze wzmocnionego ABS, z zabezpieczeniem igły biorczej po użyciu. Przyrząd posiada odpowietrznik z filtrem bakteryjnym o wysokiej skuteczności, filtr płynu 15µm. Przyrząd wyposażony w zaciskacz pozwalający na dozowanie i zatrzymanie płynu, pozostający trwale w ustalonej pozycji. Komora kroplowa dzielona na elastyczną część dolną i twardą część górną. Przyrząd przezroczysty z białym kolcem wyposażonym w skrzydełka, umożliwiające kontrolę wzrokową przepływu na całej długości drenu. Całkowita długość drenu min.150 cm. Przyrząd

pakowany pojedynczo (folia-papier), na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i dane producenta. Nazwa Producenta na zaciskaczu rolkowym.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie nr 58, Pakiet 1, Pozycja 2

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie nr 59, Pakiet 2, Pozycja 1-8

Czy Zamawiający dopuści produkty sterylne, wykonane z wysokiej jakości medycznego PCV zawierającego śladowe ilości ftalanów, z drenem 210cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 60, Pakiet 2, Pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, elektrostatyczny, o masie 29g, przestrzeń martwa: 45ml; sterylne; pakowany pojedynczo; z portem kapno; skuteczność filtrowania dla wirusów 99,9995% i bakterii 99,9999%, wolny od ftalanów, data ważności na opakowaniu jednostkowym?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 61, Pakiet 2, Pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową, których budowa jest zgodna z budową anatomiczną gardła, wygięcie około 70st pozwalające na łatwe zakładanie. Koniuszek mankietu bez tendencji do podwijania się, o budowie jak na zdjęciu:



, bez możliwości stosowania w MRI, występujący w rozmiarach 1-5?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 62, Pakiet 2, Pozycja 11-12

Czy Zamawiający dopuści produkty sterylne, wykonane z wysokiej jakości medycznego PCV zawierającego śladowe ilości ftalanów?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 63, Pakiet 2, Pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści obwód posiadający

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonany z wysokiej jakości EVA oraz PP
- Uniwersalne połączenie 22M/15F oraz 22F umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów oraz urządzeń do wentylacji mechanicznej lub aparatu do znieczulenia
- Regulowana długość obwodu umożliwiająca dopasowanie długości układu oddechowego oraz optymalizację przestrzeni martwej
- Rozciągliwe ramiona o długości max 160 cm, połączone łącznikiem Y
- Dodatkowa rozciągliwa rura o długości max 100 cm
- Bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 1 litra lub 3 litrów oraz łącznik
- Rozłączalne kolanko z portem Luer-Lock z koreczkiem
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylne, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia

?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 64, Pakiet 3, Pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści na wezwanie próbki niesterylne?

Odp. Tak

Pytanie nr 65, Pakiet 3, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninową nieprzylepną z tolerancją rozmiaru +/- 5cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 66, Pakiet 3, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę i igły bez opakowania jednostkowego (igły zabezpieczone plastikową nakładką)?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 67, Pakiet 3, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz Mayo Hegar 15cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 68, Pakiet 3, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołożonym pojemnikiem 120ml i miską nerkową PVC?

Odp. Tak

Pytanie nr 69, Pakiet 3, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz 15cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 70, Pakiet 3, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę i igły bez opakowania jednostkowego (igły zabezpieczone plastikową nakładką)?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 71, Pakiet 3, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninową 50cm x 75cm z przylepnym otworem 6cm x 8cm?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 72, Pakiet 3, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninową 50cm x 70cm nieprzylepną?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 73, Pakiet 3, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 74, Pakiet 3, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołożonym pojemnikiem 3-komorowym?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 75, Pakiet 3, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści tufery z gazy 20cm x 20cm?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 76, Pakiet 3, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołożonym pojemnikiem?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 77, Pakiet 3, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1 X Ostrze chirurgiczne nr 11, dł. 4,4cm

3 X Tupfer włókninowy bez nitki RTG, 30G 20cm x 20cm

1 X Pęseta anatomiczna metalowa 12cm

1 X Pęseta plastikowa 12,5cm niebieska?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 78, Pakiet 6, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch półksiężycy?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 79, Pakiet 6, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch grubych ringów?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 80, Pakiet 6, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rurki ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch półksiężycy?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 81, Pakiet 6, Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rurki z polipropylenowym (PP) blokerem zagryzienia, występujące w rozmiarach od 40mm do 110mm?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 82, Pakiet 6, Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści przewodnice w rozmiarach od 2,0 do 4,7mm, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 83, Pakiet 6, Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu (FEP) w rozmiarze 22G 0,9 x 25mm i 36ml/min, opakowanie twardy blister (PVC + lakierowany papier) z kolorowym zadrukiem?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 84, Pakiet 6, Pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu (FEP) o przepływie 305ml/min, opakowanie twardy blister (PVC + lakierowany papier) z kolorowym zadrukiem?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 85, Pakiet 6, Pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu (FEP) w rozmiarze 20G 1,1 x 32mm i 56ml/min, opakowanie twardy blister (PVC + lakierowany papier) z kolorowym zadrukiem?

Odp. Tak

Pytanie nr 86, Pakiet 6, Pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu (FEP) w rozmiarze 18G 1,3 x 45mm i 90ml/min, opakowanie twardy blister (PVC + lakierowany papier) z kolorowym zadrukiem?

Odp. Tak

Pytanie nr 87, Pakiet 6, Pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu (FEP) w rozmiarze 17G 1,5 x 45mm i 142ml/min, opakowanie twardy blister (PVC + lakierowany papier) z kolorowym zadrukiem?

Odp. Tak

Pytanie nr 88, Pakiet 6, Pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu (FEP) o przepływie 200ml/min, opakowanie twardy blister (PVC + lakierowany papier) z kolorowym zadrukiem?

Odp. Tak

Pytanie nr 89, Pakiet 6, Pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści kaniule dla dzieci i noworodków 0,7 o przepływie 23ml/min i 0,6 o przepływie 17 ml/min, wykonane z teflonu (FEP), w opakowaniu: twardy blister (PVC + lakierowany papier) z kolorowym zadrukiem?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 90, Pakiet 6, Pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści igłę do aspiracji 16G 10/50MM?

Odp. Tak

Pytanie nr 91,

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 w poz. 1 dopuści przyrząd o długości 80mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.)

Zamawiający informuje, że ulegną zmianie niżej wymienione terminy:

- 1) Termin związania z ofertą : **13.02.2023** r.
- 2) Termin złożenia ofert: **12.01.2023** godz.10.00
- 3) Termin otwarcia ofert: **12.01.2023** godz.10.30

Stosowną informację o zmianie w/w terminów Zamawiający zamieścił w Biuletynie

Zamówień Publicznych.

*/p.o. Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kole
Grzegorz Gibaszek/*